

1181 Budapest, Nyerges u. 6. ■ Telefon:(1)297-3131. fax:(1)295-3642, mobil:(30)685-8313 ■ www.stieber.hu ■ info@stieber.hu

## VIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY

MUNKA SZÁMA: **M 879/2022**

BIZONYÍTVÁNY SZÁMA: **N 069/2022**

Megnevezés: Szén-monoxid riasztó  
 Gyártó neve: Resideo Technologies, Inc.  
 Típusa: R200C-2  
 Gyári száma: R200C-2/001  
 A megrendelő neve és címe: Resideo Kft.  
 8800 Nagykanizsa, Dózsa György u. 147.

**A vizsgálathoz alkalmazott használati etalonok gyári száma, hitelesítési bizonyítványának száma és kelte:** D357582, GKL.Kbiz-023/2020, 2020.02.06.; D168040, GKL.Kbiz-115/2021, 2021.07.05.; D357570, GKL.Kbiz-025/2020, 2020.02.06.; Gázkeverő, Signal Model 821, gyári szám: 12940, OMSZ 06/2020

**Vizsgálati módszer és a minősítés kritériuma: összehasonlítás hiteles gáz etalonnal az MSZ EN 50291-1:2018 szabvány 6.3.2.2 pontja szerint**

### Ellenőrző műszer:


Megnevezés: Gázmonitor  
 Gyártó neve: Industrial Scientific  
 Típusa: Ventis MX4  
 Gyári száma: 11092Y8-001

A környezeti hőmérséklet: 23,3 °C  
 A légköri nyomás: 1002,0 hPa

### A mérési eredmények:

Komponens	Helyes érték	Szabvány szerinti vizsgálati pontok	Ellenőrző műszer által mért érték	Riasztási idők szabvány szerint	Minősítés
CO	29,6 ppm	27 ± 3 ppm	30 ppm	120 percig nincs	Megfelelt
CO	50,0 ppm	55 ± 5 ppm	50 ppm	60-90 perc között (83. percben)	Megfelelt
CO	99,9 ppm	110 ± 10 ppm	100 ppm	10-40 perc között (31. percben)	Megfelelt
CO	300,9 ppm	330 ± 30 ppm	302 ppm	3 percen belül (2:45)	Megfelelt

A jelen bizonyítvány csak teljes formájában érvényes és másolható, kivonatos másolat csak a bizonyítványt kibocsátó szervezet hozzájárulásával készíthető.

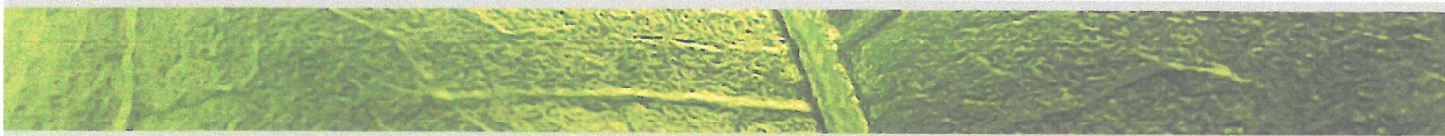

1181 Budapest, Nyerges u. 6. ■ Telefon:(1) 297-3131, fax:(1) 295-3642, mobil:(30) 685-8313 ■ www.stieber.hu ■ info@stieber.hu

MUNKA SZÁMA: **M 879/2022**

BIZONYÍTVÁNY SZÁMA: **N 069/2022**

A bevizsgálás helye: STIEBER Levegőtisztaság-védelmi Bt. Kalibráló Laboratórium

A bevizsgálás időpontja: 2022. 08. 24.

A bizonyítvány kiállításának időpontja: 2022. 08. 24.

A kalibrálást végezte: Meizner Zsolt

A kalibrálási bizonyítványt jóváhagyta: Izmindi Zsuzsanna



*A bizonyítvány kiadható!*



1181 Budapest, Nyerges u. 6. ■ Telefon:(1)297-3131, fax:(1)295-3642, mobil:(30)685-8313 ■ www.stieber.hu ■ info@stieber.hu

## VIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY

MUNKA SZÁMA: **M 880/2022**

BIZONYÍTVÁNY SZÁMA: **N 070/2022**

Megnevezés: Szén-monoxid riasztó  
 Gyártó neve: Resideo Technologies, Inc.  
 Típusa: R200C-2  
 Gyári száma: R200C-2/002  
 A megrendelő neve és címe: Resideo Kft.  
 8800 Nagykanizsa, Dózsa György u. 147.

**A vizsgálathoz alkalmazott használati etalonok gyári száma, hitelesítési bizonyítványának száma és kelte:** D357582, GKL.Kbiz-023/2020, 2020.02.06.; D168040, GKL.Kbiz-115/2021, 2021.07.05.; D357570, GKL.Kbiz-025/2020, 2020.02.06.; Gázkeverő, Signal Model 821, gyári szám: 12940, OMSZ 06/2020

**Vizsgálati módszer és a minősítés kritériuma: összehasonlítás hiteles gáz etalonnal az MSZ EN 50291-1:2018 szabvány 6.3.2.2 pontja szerint**

### Ellenőrző műszer:

Megnevezés: Gázmonitor  
 Gyártó neve: Industrial Scientific  
 Típusa: Ventis MX4  
 Gyári száma: 11092Y8-001

A környezeti hőmérséklet: 23,3 °C

A légköri nyomás: 1002,0 hPa

### A mérési eredmények:

Komponens	Helyes érték	Szabvány szerinti vizsgálati pontok	Ellenőrző műszer által mért érték	Riasztási időök szabvány szerint	Minősítés
CO	29,6 ppm	27 ± 3 ppm	30 ppm	120 percig nincs	Megfelelt
CO	50,0 ppm	55 ± 5 ppm	50 ppm	60-90 perc között (72. percben)	Megfelelt
CO	99,9 ppm	110 ± 10 ppm	100 ppm	10-40 perc között (16. percben)	Megfelelt
CO	300,9 ppm	330 ± 30 ppm	302 ppm	3 percen belül (2:30)	Megfelelt

A jelen bizonyítvány csak teljes formájában érvényes és másolható, kivonatos másolat csak a bizonyítványt kibocsátó szervezet hozzájárulásával készíthető.



MUNKA SZÁMA: **M 880/2022**

BIZONYÍTVÁNY SZÁMA: **N 070/2022**

A bevizsgálás helye: STIEBER Levegőtisztaság-védelmi Bt. Kalibráló Laboratórium

A bevizsgálás időpontja: 2022. 08. 24.

A bizonyítvány kiállításának időpontja: 2022. 08. 24.

A kalibrálást végezte: Meizner Zsolt

A kalibrálási bizonyítványt jóváhagyta: Izmindi Zsuzsanna



*A bizonyítvány kiadható!*

## VIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY

MUNKA SZÁMA: **M 881/2022**

BIZONYÍTVÁNY SZÁMA: **N 071/2022**

Megnevezés: Szén-monoxid riasztó  
 Gyártó neve: Resideo Technologies, Inc.  
 Típusa: R200C-2  
 Gyári száma: R200C-2/003  
 A megrendelő neve és címe: Resideo Kft.  
 8800 Nagykanizsa, Dózsa György u. 147.

**A vizsgálathoz alkalmazott használati etalonok gyári száma, hitelesítési bizonyítványának száma és kelte:** D357582, GKL.Kbiz-023/2020, 2020.02.06.; D168040, GKL.Kbiz-115/2021, 2021.07.05.; D357570, GKL.Kbiz-025/2020, 2020.02.06.; Gázkeverő, Signal Model 821, gyári szám: 12940, OMSZ 06/2020

**Vizsgálati módszer és a minősítés kritériuma: összehasonlítás hiteles gáz etalonnal az MSZ EN 50291-1:2018 szabvány 6.3.2.2 pontja szerint**


### Ellenőrző műszer:

Megnevezés: Gázmonitor  
 Gyártó neve: Industrial Scientific  
 Típusa: Ventis MX4  
 Gyári száma: 11092Y8-001

A környezeti hőmérséklet: 23,3 °C  
 A légköri nyomás: 1002,0 hPa

### A mérési eredmények:

Komponens	Helyes érték	Szabvány szerinti vizsgálati pontok	Ellenőrző műszer által mért érték	Riasztási idők szabvány szerint	Minősítés
CO	29,6 ppm	27 ± 3 ppm	30 ppm	120 percig nincs	Megfelelt
CO	50,0 ppm	55 ± 5 ppm	50 ppm	60-90 perc között (80. percben)	Megfelelt
CO	99,9 ppm	110 ± 10 ppm	100 ppm	10-40 perc között (24. percben)	Megfelelt
CO	300,9 ppm	330 ± 30 ppm	302 ppm	3 percen belül (2:45)	Megfelelt

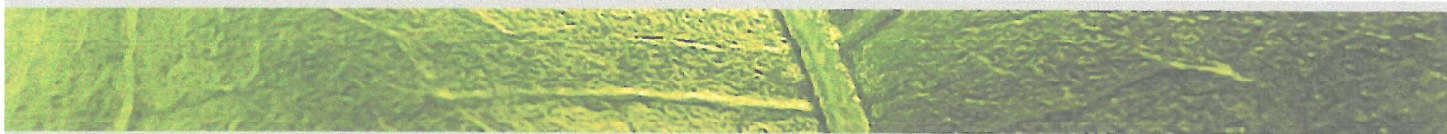

1181 Budapest, Nyerges u. 6. ■ Telefon:(1)297-3131, fax:(1)295-3642, mobil:(30)685-8313 ■ www.stieber.hu ■ info@stieber.hu

MUNKA SZÁMA: **M 881/2022**

BIZONYÍTVÁNY SZÁMA: **N 071/2022**


A bevizsgálás helye: STIEBER Levegőtisztaság-védelmi Bt. Kalibráló Laboratórium

A bevizsgálás időpontja: 2022. 08. 24.

A bizonyítvány kiállításának időpontja: 2022. 08. 24.

A kalibrálást végezte: Meizner Zsolt

A kalibrálási bizonyítványt jóváhagyta: Izmindi Zsuzsanna



*A bizonyítvány kiadható!*